

# FESZ XXIV. Kongresszus

Szakértelem és megújulás –  
**30 év** tapasztalattal a  
segédeszköz ellátás jövőjéről

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT





Gyógyászati  
segédeszköz  
ellátás  
aktualitásai

**Bidló Judit**  
Egészségügy Szakmai Irányításáért  
felelős helyettes- államtitkár  
2025. Szeptember 26.





# GYSE KIFIZETÉSEK

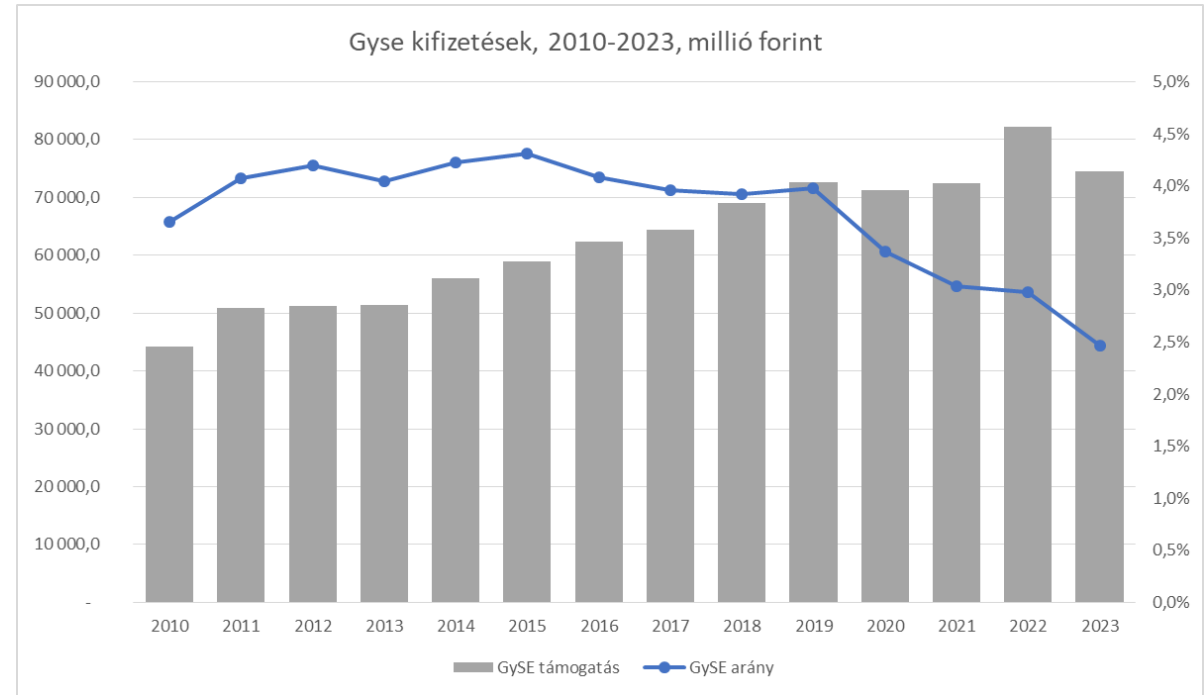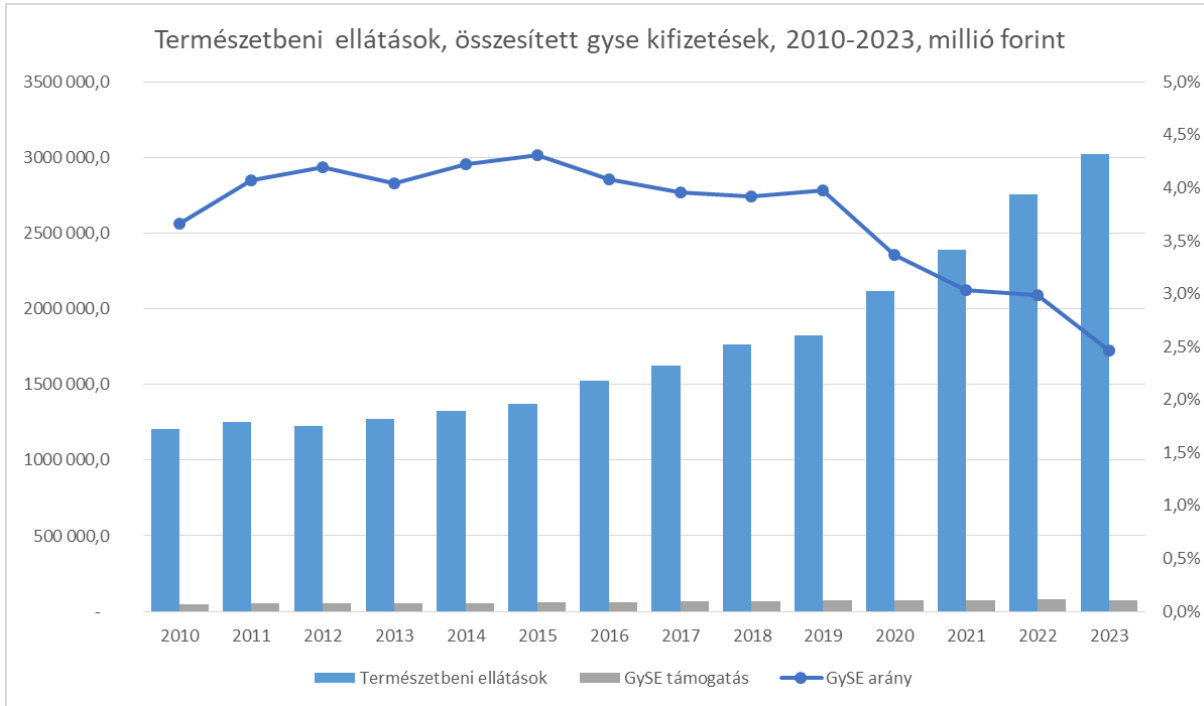



# ELLÁTOTT BETEGEK SZÁMA

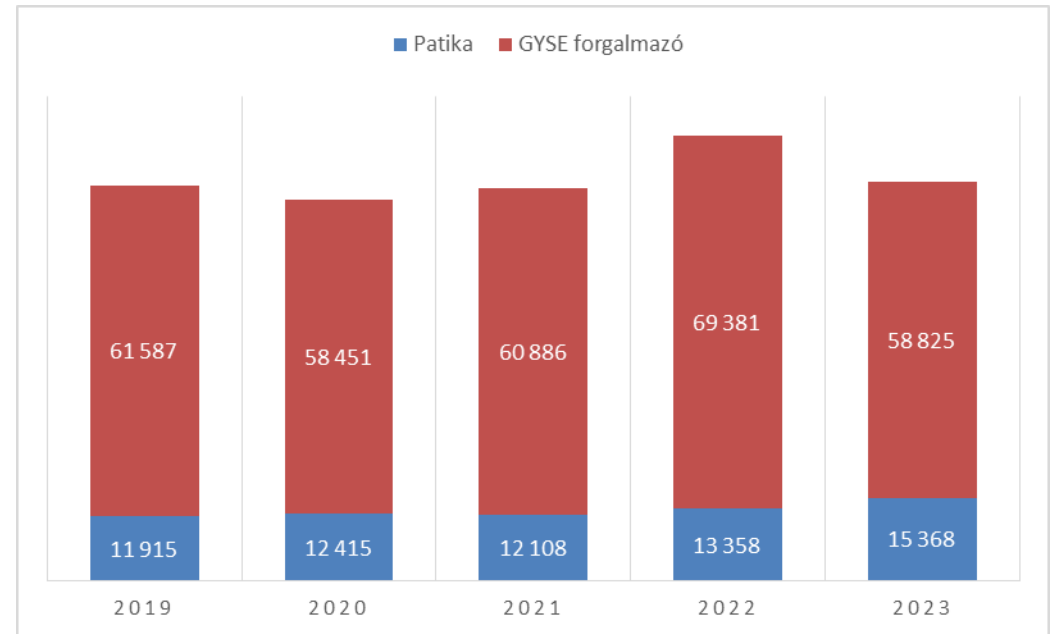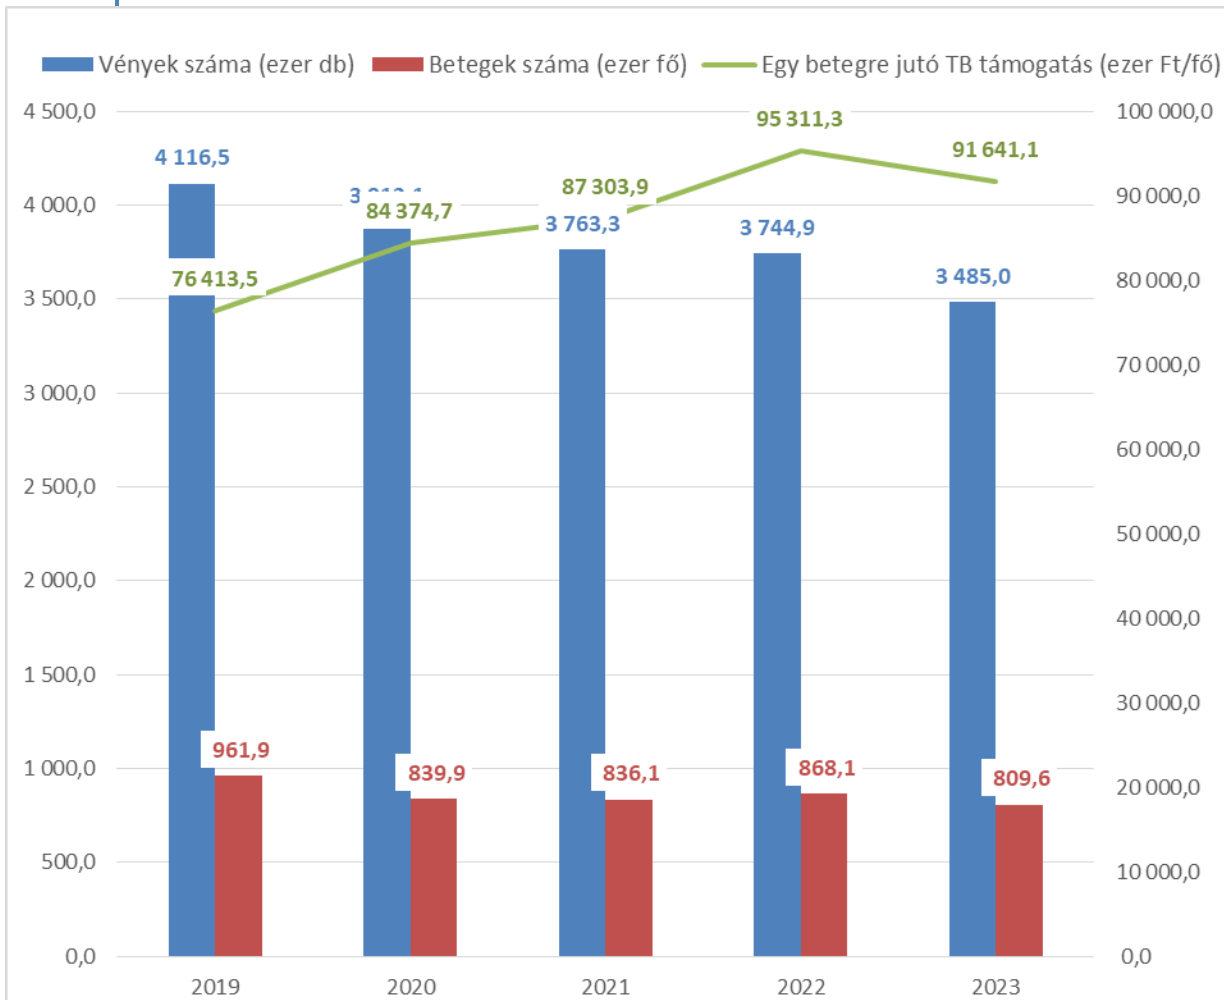




# A HOZZÁFÉRHETŐSÉGET ÉS KIHÍVÁSOKAT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK







# KERET ELOSZTÁSÁNAK DILEMMÁI - AKTUALITÁSOK

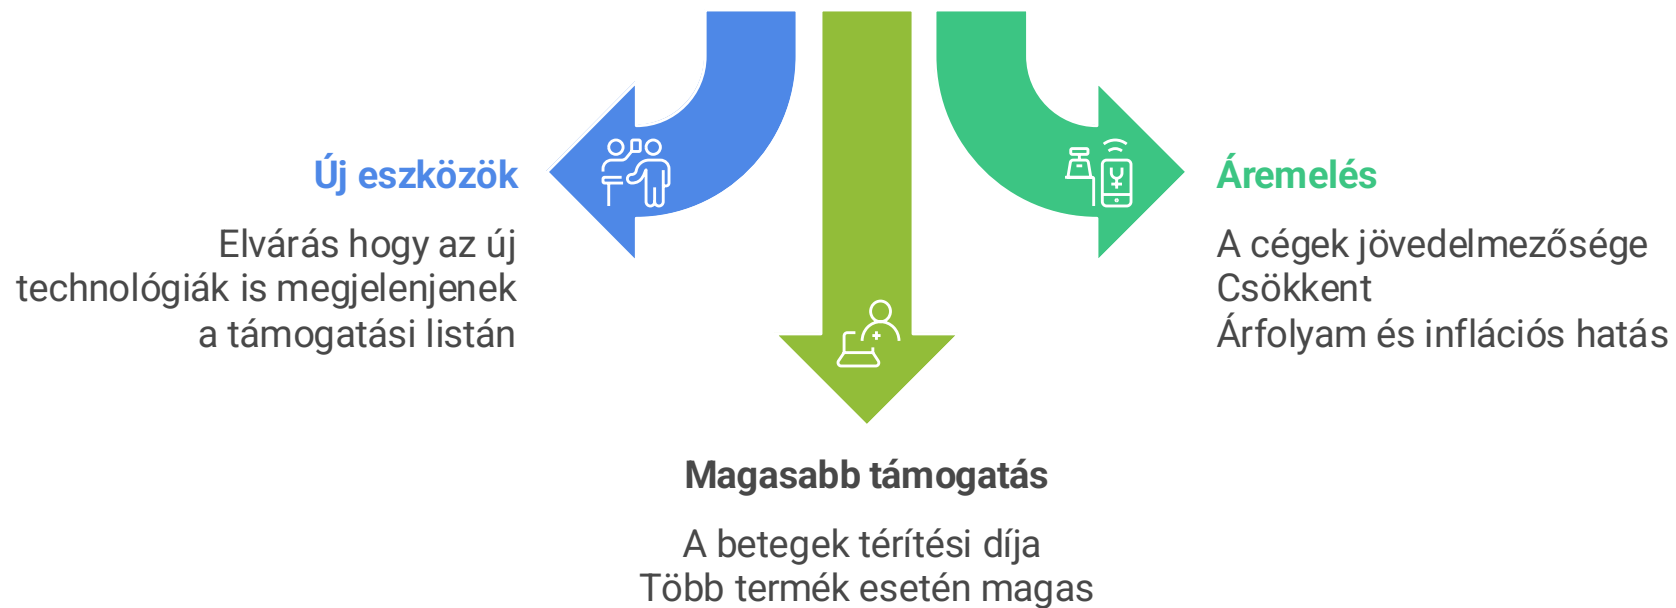



# GYSE KIADÁSOK ALAKULÁSA

GYSE KIADÁSOK ÖSSZETÉTELE 2013, 2019, 2022, 2023

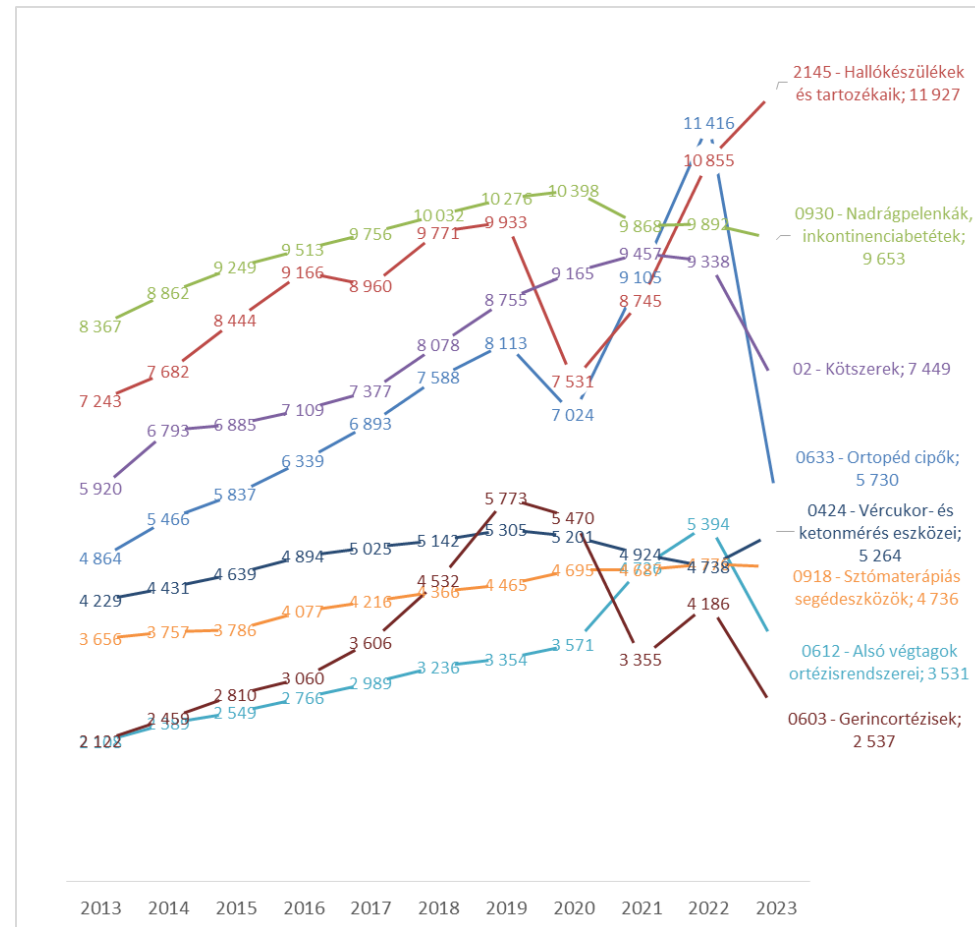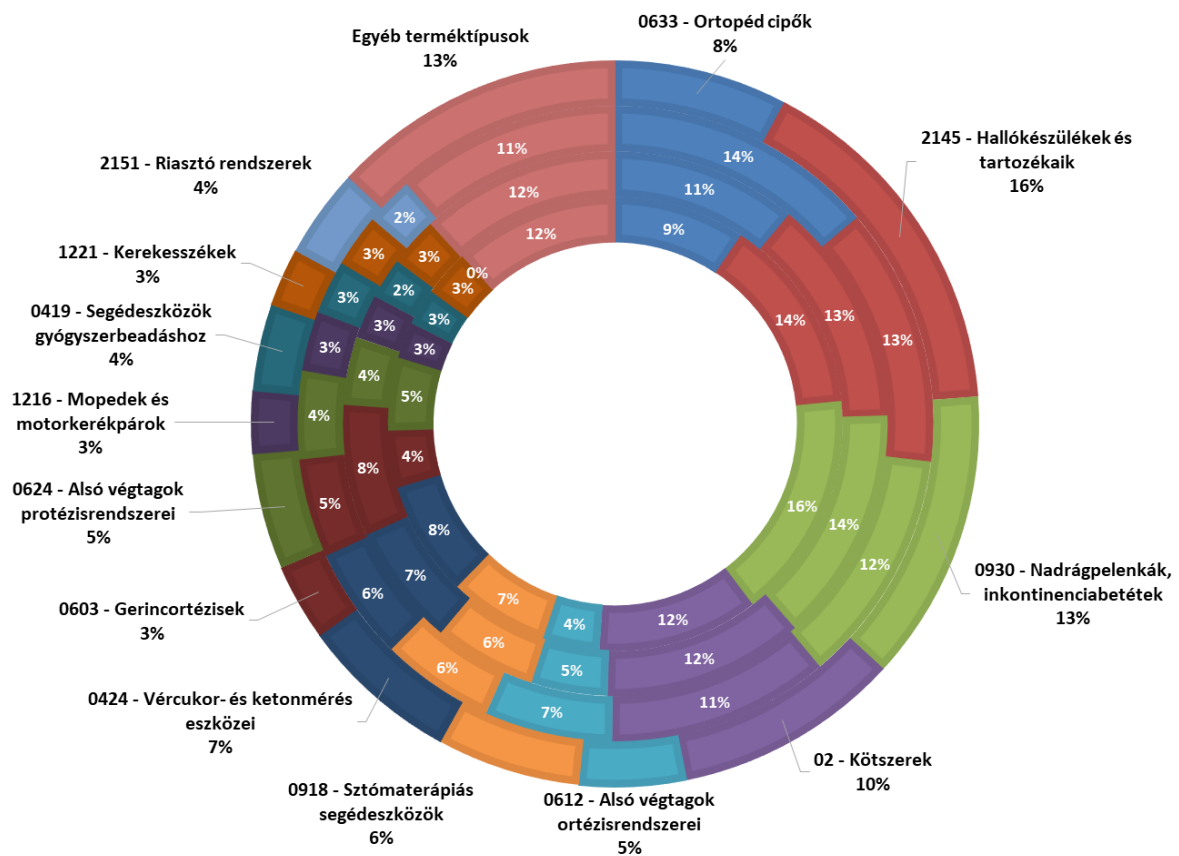



## ÚJ TERMÉKEK

Ügy tárgya	Kérelem típusa
Salus C 10 x 20 cm kötszer	új termék (aa)
Oticon Intent 4 miniRITE hallókészülék	új termék (aa)
Oticon Intent 4 miniRITE 100 hallókészülék	új termék (aa)
Medical Foam Border 10 x 10 cm kötszer	új termék (aa)
Dailee Discreet Normal (400 ml) inkontinenciabetét	új termék (aa)
Allevyn Ag Adhesive 10 x 10 cm kötszer	új termék (aa)
Hydrocoll Classic 5 x 5 cm kötszer	új termék (aa)
Rehab gondozásmentes akkumulátor 12V, 75 Ah	új termék (aa)
MIJO MS01 Kétkesz, hátsókerék-meghajtású, összecsukható	új termék (aa)
Dailee Pant Premium Super L (2005 ml) nadrágpelenka	új termék (aa)
Exufiber Ag+ 10 x 10 cm kötszer	új termék (aa)
Novopen Echo (piros) adagoló pen	új termék (aa)
Oticon Jet PX 1 miniRITE R hallókészülék	új termék (aa)
Oticon Zircon 2 miniBTE T hallókészülék	új termék (aa)
Oticon Jet PX 1 miniRITE R 100 hallókészülék	új termék (aa)
Oticon Jet PX 1 miniBTE R hallókészülék	új termék (aa)
Oticon Own SI 2 CIC hallókészülék	új termék (aa)
Oticon Own SI 2 CIC 90 hallókészülék	új termék (aa)
Oticon Jet PX 2 miniRITE R hallókészülék	új termék (aa)
Oticon Jet PX 2 miniRITE T hallókészülék	új termék (aa)
Oticon Jet PX 2 miniRITE R 100 hallókészülék	új termék (aa)
Oticon Jet PX 2 CIC hallókészülék	új termék (aa)
Oticon Jet PX 2 CIC 90 hallókészülék	új termék (aa)
Oticon Jet PX 2 ITC hallókészülék	új termék (aa)
Oticon Jet PX 2 ITC 90 hallókészülék	új termék (aa)
Oticon PG 10 BTE UP hallókészülék	új termék (aa)
ReSound Key KE361-DRWC hallókészülék	új termék (aa)

ReSound Key KE361-DRWC hallókészülék	új termék (aa)
Dailee Slip Premium Plus XS/S (1200 ml) nadrágpelenka	új termék (aa)
Dailee Comfort Premium Normal (1200 ml)	új termék (aa)
NB-222C kompresszoros inhalátor	új termék (aa)
Phonak Terra+ RIC-R P hallókészülék	új termék (aa)
Phonak Terra+ RIC-R hallókészülék	új termék (aa)
Medical Chitosan 10 x 10 cm kötszer	új termék (aa)
Nateen Flexi Basic Blue Large (1400 ml) nadrágpelenka	új termék (aa)
Nateen Flexi Plus M (2150 ml) nadrágpelenka	új termék (aa)
Phonak Virto I50 10M hallókészülék	új termék (aa)
Phonak Virto I50 10P hallókészülék	új termék (aa)
Phonak Virto I70 10M hallókészülék	új termék (aa)
Phonak Virto I70 10P hallókészülék	új termék (aa)
Signia Pure C&G BCT 5IX hallókészülék	új termék (aa)
Signia Pure C&G BCT 3IX hallókészülék	új termék (aa)
CoaguChek INRange mérőkészülék	új termék (aa)
CoaguChek XS PT PST 24 db tesztcsík	új termék (aa)
Eurochair2 2.750 kerekesszék	új termék (aa)
Femto R 1.180 aktív kerekesszék	új termék (aa)
Signia Intuis M 4.5 hallókészülék	új termék (aa)
Signia Intuis M 4.3 hallókészülék	új termék (aa)
OnlyOne Large (2000 ml) nadrágpelenka	új termék (aa)
Nateen Prime Line Adult Diaper Médium (1750 ml) nadrágpelenka	új termék (aa)



# DILEMMÁK – BEFOGADÁS

## Klinikai érték

- Nincs elfogadott terápiás érték definíció
- Korlátozott klinikai vizsgálatok
- Nem egyértelmű a komparátor
- Egészségnyereség nehézkes meghatározása

## Gazdasági szempontok

- Nagy kezdeti befektetés dilemmája
- Térítési díj - közgyógyellátottak magas aránya

## Egészségpolitikai szempontok

- Szociális és egészségügyi ellátás keveredése
- Rendkívüli érzékenység
- Rehabilitáció fontossága



## DILEMMÁK - JOGOSULTÁG


- Vertikális és horizontális méltányosság figyelembe vétele
- Az eszköz alkalmazhatóságának megítélése – tényleg tudja-e a beteg használni, akár finom motoros mozgás, akár informatikai kompetenciák megléte
- Otthonápolás támogatása
- Szükséges mennyiség optimalizálása



## DILEMMÁK - FELÍRÁS

### Háziorvos

- Jobban ismeri a beteget – könnyen jut el hozzá a beteg
- Kisebb leterheltség
- Eszköz ismerete korlátozottabb minden területen
- Diagnosztika nem mindig áll rendelkezésre



### Szakorvos

- Kevesebbet találkozik a beteggel – nehezebben jut el hozzá a beteg
- Nagyobb leterheltség
- Eszközismeret sokkal jobb az adott területen
- Jobb diagnosztikai háttér



# ÁREMELES

Ügy tárgya	Kérelem típusa
Tena Pants Normal S (1189 ml) nadrágpelenka	áremelés (bf)
Tena Pants Extra S (1843 ml) nadrágpelenka	áremelés (bf)
Tena Pants Normal M (1298 ml) nadrágpelenka	áremelés (bf)
Tena Pants Extra M (1890 ml) nadrágpelenka	áremelés (bf)
Tena Pants Normal L (1614 ml) nadrágpelenka	áremelés (bf)
Tena Pants Extra L (1910 ml) nadrágpelenka	áremelés (bf)
Seni Optima Super S (1500 ml) nadrágpelenka	áremelés (bf)
Seni Optima Super M (2100 ml) nadrágpelenka	áremelés (bf)
Seni Optima Super L (2400 ml) nadrágpelenka	áremelés (bf)
Seni Optima Super XL (2600 ml) nadrágpelenka	áremelés (bf)
Seni San Plus (2800 ml) inkontinenciabetét	áremelés (bf)
Tena Men Level 2 (450 ml) hímvesszőpelenka	áremelés (bf)
Tena Men Level 1 (275 ml) hímvesszőpelenka	áremelés (bf)
Tena Men Level 3 (710 ml) hímvesszőpelenka	áremelés (bf)
V5 Smart Series Quiet Life oxigénkoncentrátor	áremelés (bf)
MiniMed 780G inzulinpumpa	áremelés (bf)
Guardian 4 szenzor	áremelés (bf)
Guardian szenzor	áremelés (bf)
Guardian 4 szenzor inzulinpumpához	áremelés (bf)
Guardian Link 3 távadó	áremelés (bf)
Guardian 4 távadó inzulinpumpához	áremelés (bf)

Ügy tárgya	Kérelem típusa
Matocomp steril vágott mull-lap 6 x 6 cm	áremelés (bf)
Matocomp steril vágott mull-lap 10 x 10 cm	áremelés (bf)
Elektra-6000 moped	áremelés (bf)
F 23 (OrtoProfil Centrum) Adaptív ágyék-keresztcsont ortézisek	áremelés (bf)
Ligasa no 10 x 15 x 1 cm kötszer	áremelés (bf)
Ortopéd cipők és tartozékaik	áremelés (bf)
Seni Standard Air Small (1200 ml) nadrágpelenka	áremelés (bf)
Seni Standard Air Medium (1800 ml) nadrágpelenka	áremelés (bf)
Seni Standard Air Large (2000 ml) nadrágpelenka	áremelés (bf)
Seni Standard Air Extra Large (2000 ml) nadrágpelenka	áremelés (bf)
Sauer Comfort 6000 öntapadós szintetikus vizeletkondom (30x)	áremelés (bf)
Seni Control Normal (395 ml) inkontinenciabetét	áremelés (bf)
Seni Control Extra (524 ml) inkontinenciabetét	áremelés (bf)
New Aspiret szívókészülék	áremelés (bf)
Mediszintech URIN 4 vizeletgyűjtő zacskó, 2 l	áremelés (bf)
Seni Man Normál (300 ml) hímvesszőpelenka	áremelés (bf)
Seni Man Extra (450 ml) hímvesszőpelenka	áremelés (bf)
Seni Active Classic S (1200 ml) nadrágpelenka	áremelés (bf)
Seni Active Classic M (1400 ml) nadrágpelenka	áremelés (bf)
Seni Active Classic L (1513 ml) nadrágpelenka	áremelés (bf)
Seni Active Classic XL (1900 ml) nadrágpelenka	áremelés (bf)
iD Expert Slip Plus L (1966 ml) nadrágpelenka	áremelés (bf)
iD Pants Plus L (1653 ml) nadrágpelenka	áremelés (bf)

ALSÓ VÉGTAGOK PROTÉZISRENDSZEREI	áremelés (bf)
ALSÓ VÉGTAGOK ORTÉZISRENDSZEREI (TESTEN VISELT)	áremelés (bf)
FELSŐ VÉGTAGOK ORTÉZISRENDSZEREI (TESTEN VISELT)	áremelés (bf)
FELSŐ VÉGTAGOK PROTÉZISRENDSZEREI	áremelés (bf)
GERINCORTÉZIS-RENDSZEREK	áremelés (bf)
HASISÉRV-SEGÉDESZKÖZÖK	áremelés (bf)
MaxioCel 10 x 10 cm kötszer	áremelés (bf)
MaxioCel 2,5 x 30 cm kötszer	áremelés (bf)
Tena Comfort Mini Plus (381 ml) inkontinenciabetét	áremelés (bf)
Tena Comfort Mini Extra (500 ml) inkontinenciabetét	áremelés (bf)
ResMed AirCurve 10 S BiPAP készülék	áremelés (bf)
ResMed AirSense 10 Autoset CPAP készülék	áremelés (bf)
Resmed Mirage Micro nazális maszk	áremelés (bf)
RESMED Swift FX orrpárna maszk	áremelés (bf)
RESMED Swift FX for Her orrpárna maszk (női)	áremelés (bf)
RESMED Mirage FX orrmaszk	áremelés (bf)
RESMED Mirage FX for her orrmaszk (női)	áremelés (bf)
ResMed AirFit N10 orrmaszk	áremelés (bf)
ResMed AirFit N10 for Her orrmaszk	áremelés (bf)
ResMed AirFit P10 orrpárna maszk	áremelés (bf)
ResMed AirFit P10 for Her orrpárna maszk	áremelés (bf)
ResMed 37300-Kit fűtött párasító egység	áremelés (bf)
ResMed AirSense 10 Elite CPAP készülék	áremelés (bf)
V-55/M	áremelés (bf)
V-46/M	áremelés (bf)
Traumás fűző	áremelés (bf)
F 25 hosszú gerincfűző	áremelés (bf)



# TÁMOGATÁS EMELÉS - JOGOSULTSÁGI ANOMÁLIÁK

**INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉS**  
**SOKAT ÁLL? SOKAT JÁR? FÁJ A LÁBA, HÁTA,  
DEREKA?**

Lúdtalp- harántsüllyedés-lábfáradtság-sarokfájdalom-  
lábfejtorzulás-kalapácsujj-sarkantyú?

**KIHELYEZETT ORTOPÉD SZAKRENDELÉS**

**Perbál, Községi Ház**

**2022. Július 4. (hétfő) 9.00 – 13.00**

Az **ortopéd cipő** méretvétel alapján, a kívánt **korrekciókat** beépítve egyedi gyártással készül el a páciens lábához igazítva, A fazon és szín **katalógus alapján** a beteg által **megválasztható**. Vizsgálat után azonnali méretvétel, fizetés a cipő leszállításakor.  
**A (bőr) gyógycipő ára 2.000 Ft. (kettőezer forint)**

**A vizsgálathoz szükséges! Hozd magaddal!!**



- Lakcím kártya

- TAJ kártya

- Közgyógyellátási igazolvány (ha van)



**FIGYELEM! Aki az elmúlt egy évben kapott ortopéd cipőt, az most nem jogosult rá!**

Részvételi szándékodat kérlek jelezd a perbáli Postahivatalban.

Minden érdeklődőt vár

a Patakok Életmód Egyesület



Írd ide, mit keresel...



Jófogás / Jármű / Egyéb jármű / Elektromos jármű / Nógrád / Zagyvaróna, Salgótarján





# ELLENŐRZÉSI ELVÁRÁSOK

## Összeférhetetlenség

- Forgalmazóval való kapcsolat
- Tényleges teljesítés

**Elektronikus recept felírása a rendelési helynek megfelelően.**

## Indikáció igazolása

- Dokumentált
- Nyomon követhető

**Az indikáció telemedicinával nem igazolható**

## Termék megfelelősége



- Célnak megfelelő
- Nyomon követhető

**A papucs nem cipő**

- Betegek nem mindig emlékeznek
- Felírás kori állapot nehezen rekonstruálható
- Eszköz megfelelősége nehezen ellenőrizhető
- Ha a beteg megkapja az eszközt, de nem használja, nem szankcionálható



## EGYEDI MÉLTÁNYOSSÁG

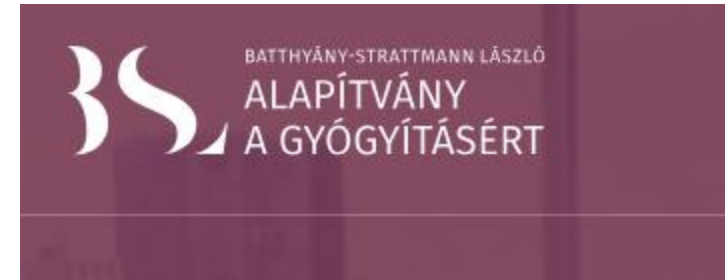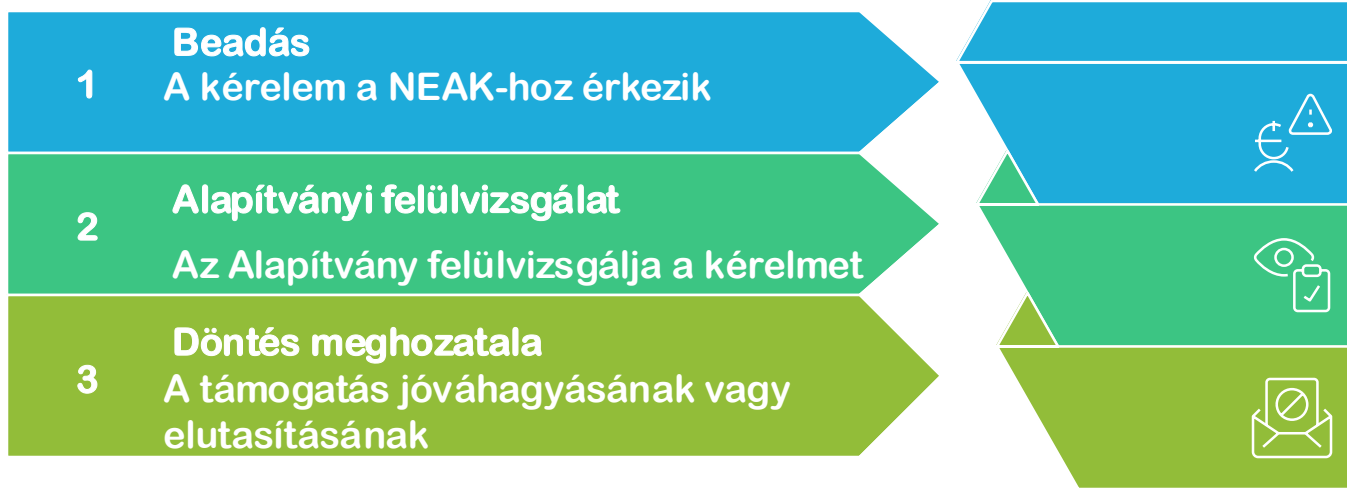

530 db kérelem, 289 engedély

Nem kell eredeti recept majd

Egyeztetési lehetőség



## FESZ JAVASLATOK

### 26. sz melléklet kibővítése

- ISO 09 15 TRACHEOSTOMIÁS SEGÉDESZKÖZÖK;
- ISO 09 18 STOMA TERÁPIÁS SEGÉDESZKÖZÖK;
- ISO 09 24 VIZELETELVEZETŐK
- ISO 09 27 VIZELETGYŰJTŐK
- ISO 18 12 ÁGYAK
- ISO 21 42 SZEMTŐL SZEMBENI KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK
- ISO 12 06 KÉT KARRAL MŰKÖDTETETT, JÁRÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK

### Szolgáltatási díj

- Az ellátásbiztonság és az egyenlő hozzáférés esélyének kiegyensúlyozott javítása a támogatott GYSE alkalmazását igénylő terápiás területeken és eszközcsoportokban a 364/2010 Korm. r. mintájára értelmezett szolgáltatási díj Gyógyászati Segédeszközökre való adaptálásával

### Egyéb

- Nemzeti Egészségstratégia integráns részeként
- GYSE ellátást egészségügyi tevékenységként szükséges jogi értelemben definiálni
- A gyógyászati segédeszközök kiszolgáltatásához tartozó tevékenységek és szolgáltatás elemek jogszabályba emelése
- Egészségügyi Szakmai Kollégium önálló GYSE Szakmai Tagozata és a gyógyászati segédeszköz ellátás, illetve a GYSE-szolgáltatók szakfelügyeletének megalakítása
- GYSE szaküzletek is kereshetőek kell legyenek az EESZT felületen

**Köszönöm a megtisztelő  
figyelmet!**